



Warszawa, dn. 09 kwietnia 2020 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę nowego, nieużywanego systemu następnej generacji wraz z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność systemu z pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów startowych” (znak sprawy DA.22.2.2020.ZM)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy rozdziału XVI SIWZ, ustęp 3, podpunkt 3 oraz załącznika 1c - część III.

W treści SIWZ Zamawiający zapisał:

„Zamawiający wymaga udzielenia **min. 12 miesięcznego okresu gwarancji** na przedmiot zamówienia od daty protokolarnego odbioru”

Natomiast w załączniku nr 1c do postępowania Zamawiający zapisał:

„Do modułu dołączone odczynniki i plastiki startowe:

- 96-cio dołkowe okrągło-denne płytki „deepwell” o pojemności dołka 0,8 ml, pakowane oddzielnie - **50 sztuk**
- Płytki 96-dołkowe, min. **50 sztuk**
- Folie do płytek 96-dołkowych- min. **50 sztuk**
- Probówki o poj. 0,2 ml w stripach (min. 120szt.) – **1 op.**
- Zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji i namnażania cDNA w jednej reakcji (min. 200 reakcji) – **1 op.**
- Autoryzowany serwis na terenie Polski
- Gwarancja min. 24 miesiące
- Instalacja, szkolenie aplikacyjne w siedzibie użytkownika
- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim”

Prosimy o wyjaśnienie. Którego z produktów dotyczy 24 m gwarancji skoro w podsumowaniu znajdujemy wymogi dotyczące całości specyfikacji.



Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że gwarancja min. 24 miesiące dotyczy systemu do analizy real-time PCR wraz dodatkowymi modułami, stanowiącymi całość systemu (część III poz.2), natomiast 12 miesięczny okres gwarancji jest wymagany dla modułu stanowiącego część III poz. 1.

Pytanie 2

Dotyczy rozdziału I SIWZ, ustęp 7 oraz załącznika 1c - część III.

W załączniku 1c Zamawiający zapisał:

„Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany.”

W treści SIWZ znajdujemy następujący zapis:

„Wykonawca wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (**wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.**), niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze złożoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania”

Wnosimy o ujednoczenie treści SIWZ zgodnie z treścią załącznika 1c tak by brzmiał:

„Wykonawca wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (**wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. za wyjątkiem części III gdzie wymóg ten brzmi: nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany**), niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze złożoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania”

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, iż poprawne brzmienie Rozdziału I SIWZ ust. 7 jest następujące:

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.), niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze złożoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania.



Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 7 - część III.

Zamawiający zapisał:

„**Wykonawca** powinien przystąpić do usunięcia usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zawiadomienia przez **Zamawiającego** o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub faksem.”

Wnosimy o korektę w/w ustępu w odniesieniu do realizacji części III tak by brzmiał:

„**Termin reakcji serwisu Wykonawcy wynosi** ~~powinien przystąpić do usunięcia usterki lub awarii~~ **w ciągu** 3 dni robocze, liczone od dnia zawiadomienia przez **Zamawiającego** o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub faksem.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować oferuje 3 dniowy czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować przystąpienia do naprawy w przeciągu 3 dni roboczych. Kontakt telefoniczny serwisu z klientem w ciągu 3 dni roboczych niejednokrotnie zezwala na zdalne usunięcie usterki.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ustępu 7 w §7 wzoru umowy dot. części III pn.:

7. Termin reakcji serwisu Wykonawcy w przypadku usterki lub awarii wynosi 3 dni robocze, liczone od dnia zawiadomienia przez **Zamawiającego** o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub faksem.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 8 i 9 - część III.

Wnosimy o usunięcie w/w ustępów i zastąpienie ich następującym zapisem:

„**Wykonawca** powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu **18 dni roboczych**, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować gwarantuje naprawę w ciągu 18 dni roboczych.

Przedmiotem postępowania jest sprzęt laboratoryjny. Warunki serwisu opisane przez Zamawiającego są charakterystyczne w odniesieniu do aparatury medycznej.

Aby móc spełnić warunki Zamawiającego Wykonawca musiałby uwzględnić w cenie oferty dodatkowe usługi serwisu.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści ustępu 8 i podtrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczące ustępu 9 w §7 wzoru umowy dot. części III.



Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 11 - część III.

Zamawiający zapisał:

„**Wykonawca** nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był on już naprawiany trzykrotnie lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.”

Wnosimy o korektę w/w ustępu w odniesieniu do realizacji części III tak by brzmiał:

„**Wykonawca** nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, **w przypadku trzykrotnej bezskutecznej naprawy tego samego elementu lub modułu towaru** ~~jeżeli był on już naprawiany trzykrotnie~~ lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.”

Przy obecnym zapisie trzy nawet błahе naprawy w trakcie trwania gwarancji uprawniają Zamawiającego do wymiany aparatu na nowy. Producent sprzętu który chcielibyśmy zaoferować nie przewiduje takich warunków gwarancji. Aby móc sprostać wymaganiom Zamawiającego i oceniając ryzyko wystąpienia usterki, musielibyśmy uwzględnić w ofercie cenę dodatkowego sprzętu, który mógłby być wykorzystany podczas wymiany na nowy.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy §7, ustęp 11 - część III na:

11. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, w przypadku trzykrotnej bezskutecznej naprawy tego samego elementu lub modułu towaru lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp 12 - część III.

Zamawiający zapisał:

„W razie wymiany wadliwego sprzętu na nowy, okres gwarancji biegnie na wymieniony sprzęt od nowa.” Wnosimy o usunięcie w/w ustępu.

Jakakolwiek wymiana sprzętu na nowy w trakcie trwania gwarancji kupionego sprzętu wynika z pierwotnych warunków gwarancji przypisanych kupionego sprzętu.

W przypadku wymiany na nowy sprzęt Zamawiający nie może odnieść dodatkowej korzyści w postaci dodatkowych miesięcy gwarancji.

Wykonawca szacując ryzyko wystąpienia awarii przy obecnym zapisie musi wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia konieczności wymiany sprzętu np w ostatnim miesiącu trwania gwarancji.



Jeśli gwarancja miałaby być odnawiana w każdym takim przypadku, mogłoby to skutkować nawet i otrzymaniem gwarancji wiecznej – hipotetycznie - tak często jak będą wymieniane aparaty na nowe w trakcie trwania gwarancji - tak długo Zamawiający otrzymywałby dodatkową gwarancję, która nie jest uwzględniona w cenie sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy we wzorze umowy w §7, ustęp 12 - część III.

Zgodnie z art. 581 k.c. § 1 bieg terminu gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, pn.:

§ 1. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Pytanie 7

Pytanie 1 – dotyczy SIWZ ROZDZIAŁ XVI Kryteria oceny ofert pkt 3 ppkt 1) W odniesieniu do Części I zamówienia

Czy Zamawiający poprzez **wymóg udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego wsparcia technicznego** na przedmiot zamówienia rozumie odpłatną dostępność części zamiennych oraz usług serwisowych?

W takim przypadku proszę o zmodyfikowanie zapisu „Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji, tj. 60 miesięcy”, zważywszy na to, że okres gwarancji stanowi osobne kryterium oceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający informuje, iż intencją było, aby Wykonawca zagwarantował wsparcie techniczne min. 60 miesięcy zapewniając płatny serwis pogwarancyjny oraz dostępność części umożliwiających bezproblemową oraz szybką naprawę przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie, Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący kryterium II okres gwarantowanego wsparcia technicznego w ramach którego Wykonawcom zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 dla części I, II oraz III w następujący sposób pn.:

Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego wsparcia technicznego (odpłatnego serwisu pogwarancyjnego i zapewnienia dostępności części zamiennych w okresie minimum 60 miesięcy po okresie gwarancyjnym).



Pytanie 8

Pytanie 2 – dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR DA.22.2.2020.ZM-1 część I §7 pkt 7

Czy Zamawiający poprzez przestąpienie do usunięcia usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia zawiadomienia rozumie czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy, zgodnie z podanym opisem parametru w Załączniku nr 1a do umowy?

Dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający informuje, iż sposób i metodę usunięcia awarii lub usterki pozostawia serwisowi, tym samym akceptuje czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy, jeżeli nie będzie to następstwem utraty gwarancji producenta.

Pytanie 9

Pytanie 3 – dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR DA.22.2.2020.ZM-1 część I §7 pkt 8

Sekwenatory NGS są urządzeniami o znacznym stopniu złożoności konstrukcji. Czas przewidziany przez Zamawiającego na skuteczne usunięcie usterek i wad jest zbyt krótki, ponieważ częstokroć naprawa urządzenia wymaga zastosowania długotrwałych procedur kalibracyjnych a jej poprawność musi zostać potwierdzona przeprowadzeniem odpowiedniej reakcji testowej trwającej nawet kilka dni.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę gwarancyjną do 15 dni, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy §7, pkt 8 - część I, pn.: 8. Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 15 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

Pytanie 10

**Pytanie 4 – dotyczy: Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1
Parametr Minimalna ilość materiału wejściowego**

Czy Zamawiający podając jako parametr Minimalna ilość materiału wejściowego - nie więcej niż 50 ng miał na myśli ilość materiału wejściowego do przygotowania biblioteki?

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający informuje, iż miał na myśli ilość materiału wyjściowego do przygotowania bibliotek.



Pytanie 11

Pytanie 5 – dotyczy: **Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1**
Parametr Instalacja, Serwis gwarancyjny

Czy Zamawiający poprzez zapis „*gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy*” miał na myśli możliwość wykupienia dodatkowo płatnego 12 miesięcznego kontraktu serwisowego po zakończeniu 24 miesięcy zaoferowanej gwarancji?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający informuje, iż poprawny zapis będzie następujący, pn.:

- zapis „*gwarancja: co najmniej 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń*”

Pytanie 12

Pytanie 6 – dotyczy: **Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 2**

Pragniemy zauważyć, że wymagany produkt w 2 pozycji I części zamówienia nie jest urządzeniem, nie posiada ruchomych części oraz nie wymaga uruchomienia. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu jego montażu, a sprawdzenie poprawności działania będzie polegało na weryfikacji braku fizycznych uszkodzeń?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu montażu oraz że sprawdzi brak fizycznych uszkodzeń.

Pytanie 13

Pytanie 7 – dotyczy: **Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 3**

Pragniemy zauważyć, że wymagany produkt w 3 pozycji I części zamówienia nie jest urządzeniem, nie posiada ruchomych części oraz nie wymaga uruchomienia. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu jego montażu, a sprawdzenie poprawności działania będzie polegało na weryfikacji braku fizycznych uszkodzeń?

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wymogu montażu oraz że sprawdzi brak fizycznych uszkodzeń.



Pytanie 14

Pytanie 8 – dotyczy: **Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 2 i 3**

Czy Zamawiający dla 2 i 3 pozycji I części zamówienia dopuści dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika tylko w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wymaganą dokumentację techniczną oraz instrukcję użytkownika systemu w języku angielskim.

Pytanie 15

Pytanie 9 – dotyczy: **Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 5**

Czy w ramach 5 pozycji I części zamówienia Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie zestawu odczynników do znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek WGS z minimalną liczbą analiz: 24?

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający informuje, iż akceptuje zestaw odczynników do znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek WGS z minimalną liczbą 24.

Pytanie 16

Pytanie 10 – dotyczy: **Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1 Parametry oferowane przez Wykonawcę**

Czy w kolumnach, w których Zamawiający nie wskazał wymogu podania oferowanej wartości dla wskazanych parametrów potwierdzeniem ich spełnienia ma być słowo „TAK”?

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający informuje, iż w kolumnach, w których Zamawiający nie wskazał wymogu podania wartości dla wskazanego parametru, warunki określone w kolumnie „Opis Parametru” są obligatoryjne i są to minimalne wymagania dla oferty niepodlegającej odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, iż Wykonawca który złożył ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ tym samym oświadcza, że oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w częściach na które składa ofertę, opisy przedmiotów zamówienia stanowią załączniki do projektów umów, pn.:

- 1) Projekt umowy do **części I** wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr 1a do SIWZ**;
- 2) Projekt umowy do **części II** wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr 1b do SIWZ**;
- 3) Projekt umowy do **części III** wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr 1c do SIWZ**;



- 4) Projekt umowy do **części IV** wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr 1d do SIWZ**;
- 5) Projekt umowy do **części V** wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr 1e do SIWZ**;
- 6) Projekt umowy do **części VI** wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący **załącznik nr 1f do SIWZ**;

Pytanie 17

Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych za opóźnienie w dostawie do 0,2 % wartości brutto lub do możliwie najniższych wartości ?

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 12a ust. 2 ppkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale I ust. 7

BYŁO:

ROZDZIAŁ I. **Opis przedmiotu zamówienia**

7. Wykonawca wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.), niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze złożoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania.

JEST:

7. **Zamawiający** wymaga, aby dostarczony sprzęt był kompletny, wolny od wad fizycznych, jakościowych i prawnych, fabrycznie nowy (**wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r.**), niebędący przedmiotem ekspozycji, elementem szkolenia bądź innej formy użytkowania, zgodny ze złożoną ofertą i normami obowiązującymi w Polsce oraz z ostatnimi rozwiązaniami technologicznymi producenta, zapakowany w sposób gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem, a opakowanie nie będzie nosić znamion jego otwierania.



II. W projekcie umowy w § 7 ust. 7 części III

BYŁO:

7. **Wykonawca** powinien przystąpić do usunięcia usterki lub awarii w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zawiadomienia przez **Zamawiającego** o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub faksem.

JEST:

7. **Termin reakcji serwisu Wykonawcy w przypadku usterki lub awarii wynosi 3 dni robocze, liczone** od dnia zawiadomienia przez **Zamawiającego** o jej wystąpieniu w formie pisemnej – e-mailem lub faksem.

III. W projekcie umowy w § 7 ust. 8 i 9 części III

BYŁO:

8. **Wykonawca** powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

JEST:

8. Wykonawca powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu **18** dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy

IV. W projekcie umowy w § 7 ust. 8 części I

BYŁO:

8. **Wykonawca** powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

JEST:

8. **Wykonawca** powinien dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu **15** dni roboczych, liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

V. W załączniku nr 1 do umowy w części I, pozycji 1, parametry – Instalacja, serwis gwarancyjny:

BYŁO:

- czas naprawy urządzenia – maksymalnie do 28 dni roboczych



JEST:

- czas naprawy urządzenia – **maksymalnie do 15 dni roboczych/w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy maksymalnie 21 dni roboczych**

VI. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ROZDZIALE XVI Kryteria oceny ofert II w odniesieniu do części I, II, III

BYŁO:

W przypadku podania okres gwarantowanego wsparcia technicznego w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy. W przypadku nie wpisania okresu gwarantowanego wsparcia technicznego na przedmiot zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji, tj. 60 miesięcy.

Zamawiający **wymaga udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego wsparcia technicznego** na przedmiot zamówienia od daty protokolarnego odbioru.

JEST:

W przypadku podania okres gwarantowanego wsparcia technicznego w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy. W przypadku nie wpisania okresu gwarantowanego wsparcia technicznego na przedmiot zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji, tj. 60 miesięcy.

Zamawiający **wymaga udzielenia min. 60 miesięcznego okresu gwarantowanego wsparcia technicznego (odpłatnego serwisu pogwarancyjnego i zapewnienia dostępności części zamiennych w okresie minimum 60 miesięcy po okresie gwarancyjnym).**

VII. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BYŁO:

ROZDZIAŁ XII.

Składanie ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) do dnia **22 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00.**

ROZDZIAŁ XIV.

Otwarcie ofert



1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu **22 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno – Techniczny.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

JEST:

ROZDZIAŁ XII.
Składanie ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) do dnia **27 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00.**

ROZDZIAŁ XIV.
Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu **27 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno – Techniczny.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

VIII. W załączniku nr 1e do SIWZ – Projekt umowy

BYŁO:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nrw dniur. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29



stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Wykonawca zobowiązuje się do dostaw **Zamawiającemu**: „*Tworzyw sztucznych – zestaw materiałów zużywalnych umożliwiających sekwencjonowanie następnej generacji*”, zwanych dalej „**Przedmiotem Umowy**”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do złożonej Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w tym Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić za nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1.

JEST:

§ 1

Przedmiot umowy

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w **Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej** pod nrw dniur. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) **Wykonawca** zobowiązuje się do dostaw **Zamawiającemu**: „*Tworzyw sztucznych – zestaw materiałów zużywalnych umożliwiających sekwencjonowanie następnej generacji*”, zwanych dalej „**Przedmiotem Umowy**”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do złożonej Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w tym Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić za nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1.

IX. W załączniku nr 1f do SIWZ – Projekt umowy

BYŁO:


§ 1

Przedmiot umowy

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nrw dniur. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) **Wykonawca** zobowiązuje się do dostaw **Zamawiającemu** **odczynników**, zwanych dalej „**Przedmiotem Umowy**”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do złożonej Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w tym



Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić za nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1.

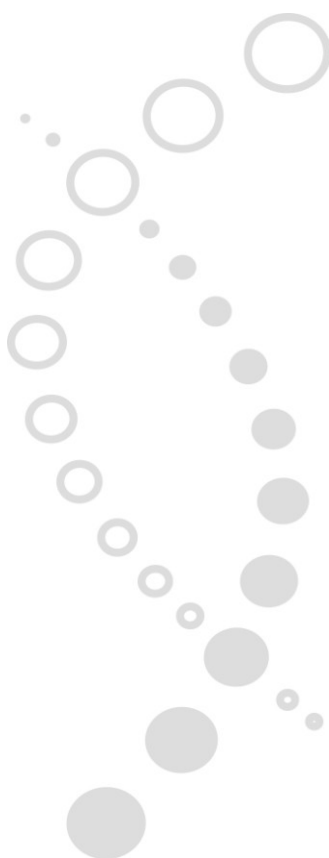



JEST:

§ 1

Przedmiot umowy

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony, ogłoszonego w **Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej** pod nrw dniur. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) **Wykonawca** zobowiązuje się do dostaw **Zamawiającemu odczynników**, zwanych dalej „**Przedmiotem Umowy**”, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, załączonym do złożonej Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, po cenach jednostkowych określonych w tym Załączniku, stanowiącym integralną część Umowy, a **Zamawiający** zobowiązuje się zapłacić za nie wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1.

X. W załączniku nr 1d do Umowy – część 4, pozycja 4:

BYŁO: Pipeta 8 kanałowa nastawna

JEST: Pipeta 12 kanałowa nastawna

XI. W załączniku nr 1b do Umowy – część 2, pozycja 1:

BYŁO:

CZĘŚĆ II – Moduł niezbędny do kompleksowej oceny bibliotek DNA do sekwencjonowania genomowej następnej generacji

POZYCJA 1 – Aparat do mikrofluidalnej elektroforezy kwasów nukleinowych

Ilość: 1 kpl.

Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany.

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,
FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



JEST:

CZĘŚĆ II – Moduł niezbędny do kompleksowej oceny bibliotek DNA do sekwencjonowania genomowej następnej generacji
POZYCJA 1 – Aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych
Ilość: 1 kpl.
Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. - nowy, nie używany.
Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

XII. W załączniku nr 1a do Umowy – część 1, pozycja 4:

BYŁO:

- kompletny zestaw do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania DNA z enzymatyczną fragmentacją materiału do przygotowania 24 prób (**1 opakowanie**)
- zakres stosowania: WGS dla małych genomów, plazmidów
- ilość wejściowego DNA – nie więcej niż 50ng
- zasada działania: fragmentacja enzymatyczna
- możliwość multipleksowania w jednej probówce wielu znakowanych próbek
- data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy
- Zamawiający podkreśla, że okres przydatności do użycia każdego z zestawów nie może być krótszy niż 3 miesiące
- Do zestawu dołączony:
- odczynnik do oczyszczania matryc PCR tworzonych bibliotek w ilości nie mniejszej niż 75 ml – **1 opakowanie**
- Odczynnik do kontroli biblioteki DNA kompatybilny z aplikacją odczytów sekwencjonowania powyżej 150 par zasad – **1 opakowanie** (**dostarczony w II transzy zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ**)

JEST:

- kompletny zestaw do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania DNA z enzymatyczną fragmentacją materiału do przygotowania 24 prób (**1 opakowanie**-**dostarczony w II transzy zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ**)
- zakres stosowania: WGS dla małych genomów, plazmidów
- ilość wejściowego DNA – nie więcej niż 50ng
- zasada działania: fragmentacja enzymatyczna
- możliwość multipleksowania w jednej probówce wielu znakowanych próbek
- data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy



- Zamawiający podkreśla, że okres przydatności do użycia każdego z zestawów nie może być krótszy niż 3 miesiące
- Do zestawu dołączony:
 - odczynnik do oczyszczania matryc PCR tworzonych bibliotek w ilości nie mniejszej niż 75 ml – **1 opakowanie (dostarczony w I transzy zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ)**
 - Odczynnik do kontroli biblioteki DNA kompatybilny z aplikacją odczytów sekwencjonowania powyżej 150 par zasad – **1 opakowanie (dostarczony w I transzy zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ)**

XIII. W Załącznik nr 1a do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I POZYCJA 1 Parametr Instalacja, Serwis gwarancyjny:

BYŁO:

- **gwarancja: co najmniej 24 miesiący od daty podpisania** protokołu odbioru bez zastrzeżeń, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy

JEST:

- **gwarancja: co najmniej 24 miesiący od daty podpisania** protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

XIV. W załączniku nr 1a do Umowy – część 1, pozycja 6:

BYŁO:

Ilość: 2 opakowania

- umożliwiający multipleksowania próbek w jednej probówce
 - minimalna liczba znaczników: 96
 - minimalna liczba analiz: 384
 - data przydatności min.3 miesiące od daty dostawy
 - zestaw kompatybilny z zaoferowanym zestawem do tworzenia bibliotek do sekwencjonowania NGS
 - data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy
- ilość: 1 opakowanie w I transzy oraz 2 opakowanie w II transzy

JEST:

Ilość: 1 opakowanie

- umożliwiający multipleksowania próbek w jednej probówce
 - minimalna liczba znaczników: 96
 - minimalna liczba analiz: 384
 - data przydatności min.3 miesiące od daty dostawy
 - zestaw kompatybilny z zaoferowanym zestawem do tworzenia bibliotek do sekwencjonowania NGS
 - data przydatności do użycia zestawu: min. 3 miesiące od daty dostawy
- ilość: **1 opakowanie w I transzy**



XV. Formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ – Część II w kolumnie „Przedmiot zamówienia”

BYŁO:

Dostawa: Aparat do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych (**zgodnie z opisem zawartym w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1b do umowy**)

JEST:

Dostawa: **Aparat do elektroforezy kwasów nukleinowych (zgodnie z opisem zawartym w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1b do umowy)**

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż załącza następujący dokumenty ze zmianami stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma, z obowiązkiem stosowania w przedmiotowym postępowaniu w częściach gdzie treść uległa zmianie, pn.:

1. Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ – po zmianach
2. Załączniki wersja edytowalna – po zmianach 09.04.2020

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu, t.j.:

1. Termin składania ofert : **27.04.2020 r. godz. 10:00**
2. Termin otwarcia ofert: **27.04.2020 r. godz. 14:00**

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--/--

prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel